
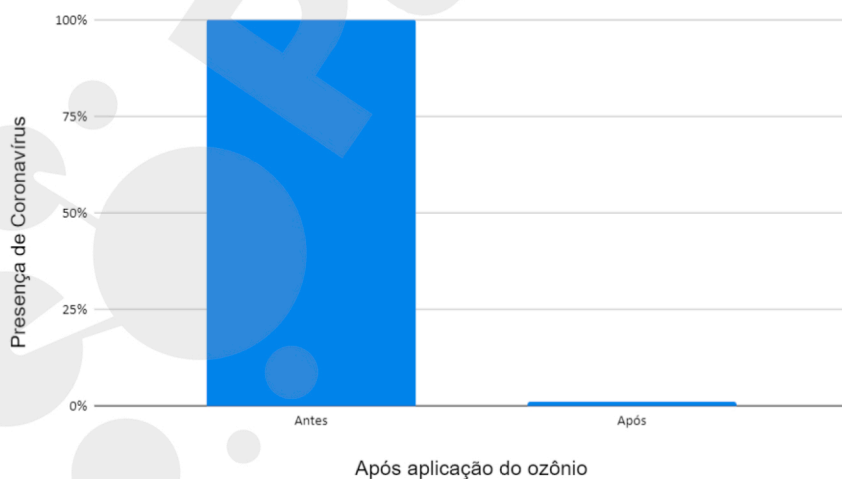


## Laudo de eficácia no combate a vírus do equipamento "Gerador de ozônio modelo O3Care M50" para reuso de máscaras

De acordo com testes realizados no Laboratório de Virologia do Instituto de Biologia da Unicamp, o **Gerador de Ozônio Panozon, Modelo O3Care M50**, foi **eficaz para a inativação de partículas virais do coronavírus**, e, portanto, o **Laboratório recomenda o uso** como potencial agente desinfetante para máscaras.

O equipamento apresentou **redução de infectividade viral em 99,99%**.

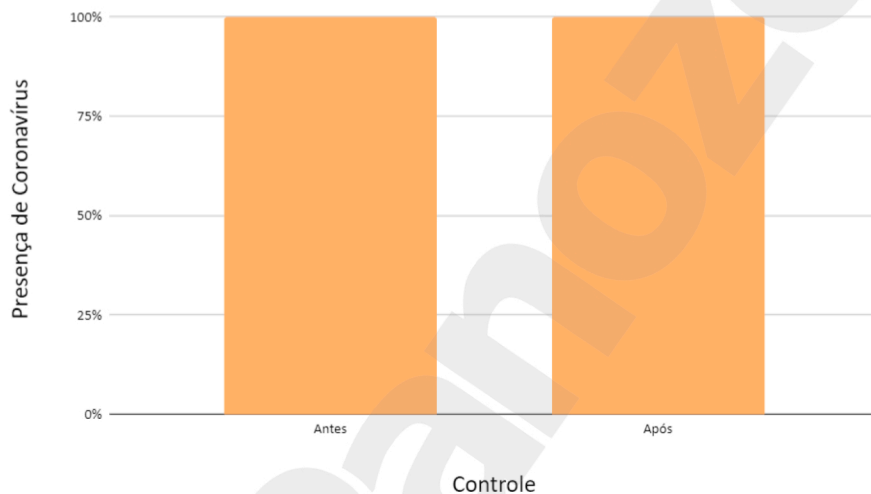

Para ter acesso ao laudo completo, entre em contato com a Panozon em [atendimento@panozon.com.br](mailto:atendimento@panozon.com.br)